




Registro de temperatura sin complicaciones

para monitorizar fiablemente la cadena de frío y los productos sensibles

¡NOVEDAD! Descarga gratuita del software en www.testo.com

Datos de medición organizados y accesibles:

- Analice • Archive • Visualice

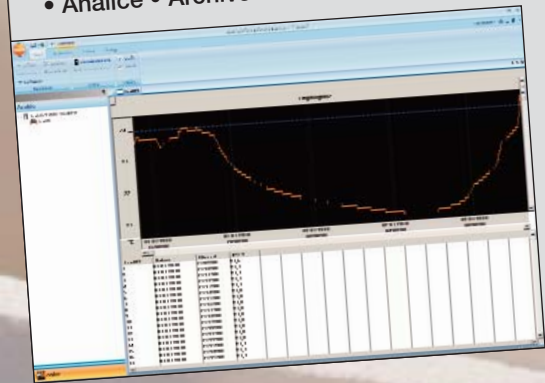

Registro de temperatura con el mini datalogger testo 174T



Imagen a tamaño real

- Datos seguros incluso si se agota la pila
- Memoria de gran capacidad
- Protección IP65
- Compacto y robusto
- Conforme a EN12830
- Alarma óptica
- Descarga de datos al PC vía interfaz USB



Mini datalogger testo 174T, 1 canal, incl sujeción mural, pilas (2 x CR 2032 Lithium) y protocolo de calibración

Modelo 0572 1560



El testo 174T es el registrador ideal para la medición de temperatura en refrigeradores, congeladores, cámaras frigoríficas y mostradores refrigerados.

Set testo 174T


Set del mini datalogger testo 174T, 1 canal, incl interfaz USB para programar y descargar los datos, sujeción mural, pilas (2 x CR 2032 Lithium) y protocolo de calibración*

Modelo 0572 0561



*Descarga gratuita del software en: www.testo.es
También puede solicitar el CD del software por separado

Software del testo 174 para PC

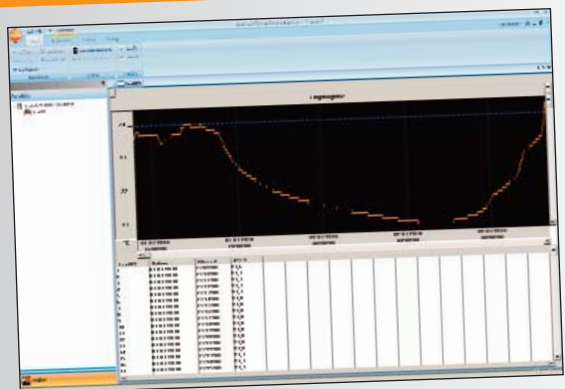

Con el software para PC Comsoft Básico es muy fácil configurar el datalogger y descargar sus datos vía interfaz USB. Los datos se analizan, se ordenan y se memorizan de forma totalmente intuitiva.

Datos técnicos

Tipo sensor	Sensor de temperatura interno, NTC
Rango medición	-30 ... +70 °C
Exactitud	± 0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Resolución	0,1 °C
Temperatura funcionam.	-30 ... +70 °C
Temperatura almacenam.	-40 ... +70 °C
Tipo pila	2 x pila botón de 3 V (CR 2032 Lithium), reemplazables por el usuario
Vida de la pila	500 días (15' intervalo de medición, a +25 °C)
Clase de protección	IP65
Intervalo de medición	1 min – 24 h (seleccionable)
Memoria	16.000 lecturas
Software	Windows XP, Vista, Win7

Accesorios

	Modelo	
Interfaz USB para programación y descarga de los datos de los dataloggers testo 174T y testo 174H	0572 0500	
CD software Comsoft Básico (si no se opta por la descarga gratuita previo registro vía página web)	0572 0580	
Pila botón CR 2032 Lithium (se deben solicitar dos pilas por cada datalogger)	0515 0028	
Certificado de calibración ISO de temperatura, puntos de calibración -18°C; 0°C; +60°C; por canal / instrumento	250520 0151	